




◆ 温湿度控制范围图



◆ 320L

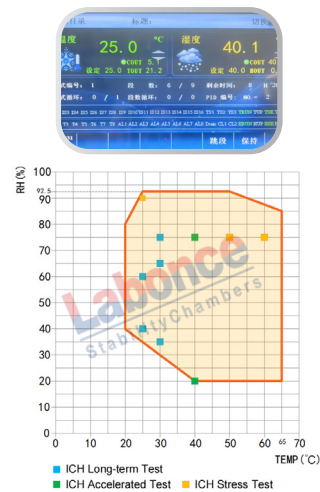


◆ 520L~620L



◆ 430L~930L

名称	型号	控温范围 (°C)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	箱体结构	备注
两箱式药品稳定性试验箱	Labonance-320GS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460	860×840×1880	2.5	2/5	上 A	温度波动度: $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度偏差: $< \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 湿度波动度: $< \pm 2\%\text{RH}$ 湿度偏差: $< \pm 3\%\text{RH}$ A/B 箱 (温度+湿度)
				150	680×500×460			2/5	下 B	
	Labonance-520GS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830	1610×870×1650	3.0	3/7	左 A	
				250	600×500×830			3/7	右 B	
	Labonance-620GS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000	1610×870×1820	3.2	3/9	左 A	
				300	600×500×1000			3/9	右 B	
三箱式药品稳定性试验箱	Labonance-430GS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	100	480×420×500	1370×780×1930	3.6	1/4	左上 A	温度波动度: $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温度偏差: $< \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 湿度波动度: $< \pm 2\%\text{RH}$ 湿度偏差: $< \pm 3\%\text{RH}$ A/B/C 箱 (温度+湿度)
				100	480×420×500			2/4	左下 B	
				230	480×420×1100			4/8	右箱 C	
	Labonance-930GS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	220	600×700×520	1570×1060×1960	4.0	1/6	左上 A	
				220	600×700×520			2/6	左下 B	
				480	600×700×1140			4/8	右箱 C	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃ 下测得。

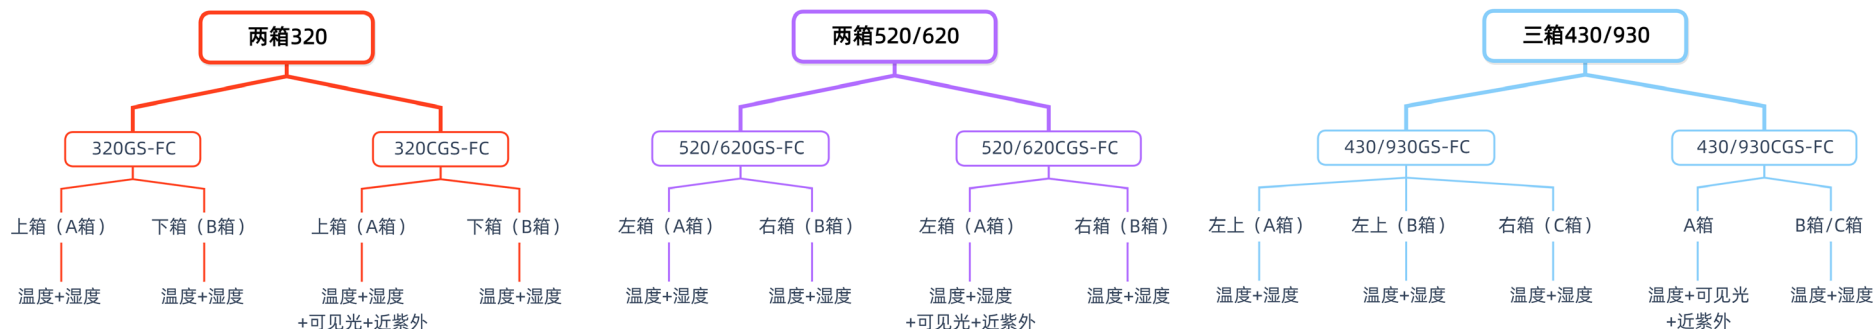

名称	型号	控温范围 (C)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	箱体 结构	备注 1
两箱式 综合药品稳定性 试验箱	Labonco-320CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460	860×840×1880	2.5	2/5	上 A	A 箱 (温度 + 湿度 + 可 见光 + 近紫外) B 箱 (温度 + 湿度)
				150	680×500×460			2/5	下 B	
	Labonco-520CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830	1610×870×1650	3.0	3/7	左 A	
				250	600×500×830			3/7	右 B	
	Labonco-620CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000	1610×870×1820	3.2	3/9	左 A	
				300	600×500×1000			3/9	右 B	
三箱式 综合药品稳定性 试验箱	Labonco-430CGS-FC	15 ~ 65	N/A	100	480×420×500	1370×780×1930	3.6	1/4	左上 A	A 箱 (温度 + 可见光 + 近紫外 , 光照开时: 同一层面 , 温度偏差为 ±2.0℃) B/C 箱 (温度 + 湿度)
			20 ~ 95%	100	480×420×500			2/4	左下 B	
			20 ~ 95%	230	480×420×1100			4/8	右箱 C	
	Labonco-930CGS-FC	15 ~ 65	N/A	220	600×700×520	1570×1060×1960	4.0	1/6	左上 A	
			20 ~ 95%	220	600×700×520			2/6	左下 B	
			20 ~ 95%	480	600×700×1140			4/8	右箱 C	
备注 2	1、CGS-FC 系列: A 箱具备温度、可见光、近紫外三种功能,照度测量标配可见光及近紫外传感器,可见光值和近紫外值均自动打印及存储; 2、可见光范围: 100 ~ 6000Lux, 照度偏差: 4500±500Lux, 光照试验的总照度不低于 1.2×10 ⁶ Lux · hr; 近紫外范围: 0.84 ~ 1.0 w/ ㎡ , 近紫外总能量不低于 200w · hr/ ㎡ ; 无光照时, 温湿度指标同 GS-FC。 3、温度波动度: < ±0.5℃ ; 温度偏差: < ±1.0℃ (无光照时) ; 湿度波动度: < ±2%RH; 湿度偏差: < ±3%RH (无光照时) 。									